

Veltmann®

Fertigschwimmbecken

RGB-LED Scheinwerfer 110




Eingangsspannung	12 V AC oder DC
Frequenz Eingangsspannung	50/60 Hz
Leistung	18 W
Temperatur Bereich	0 – 40°C
Abmessung Tiefe/Durchmesser Gehäuse	100 mm / 100 mm
RGB-LED	
IP 68 CE RoHS ERP R&TTE	

Anschluss an RGB-LED Controller mit Fernbedienung



Betriebsspannung	12 V AC
Maximaler Anschluss	20 Leuchtmittel
Reichweite Fernbedienung	Maximal 50 m
Netzteil	Keine elektronischen Netzteile verwenden

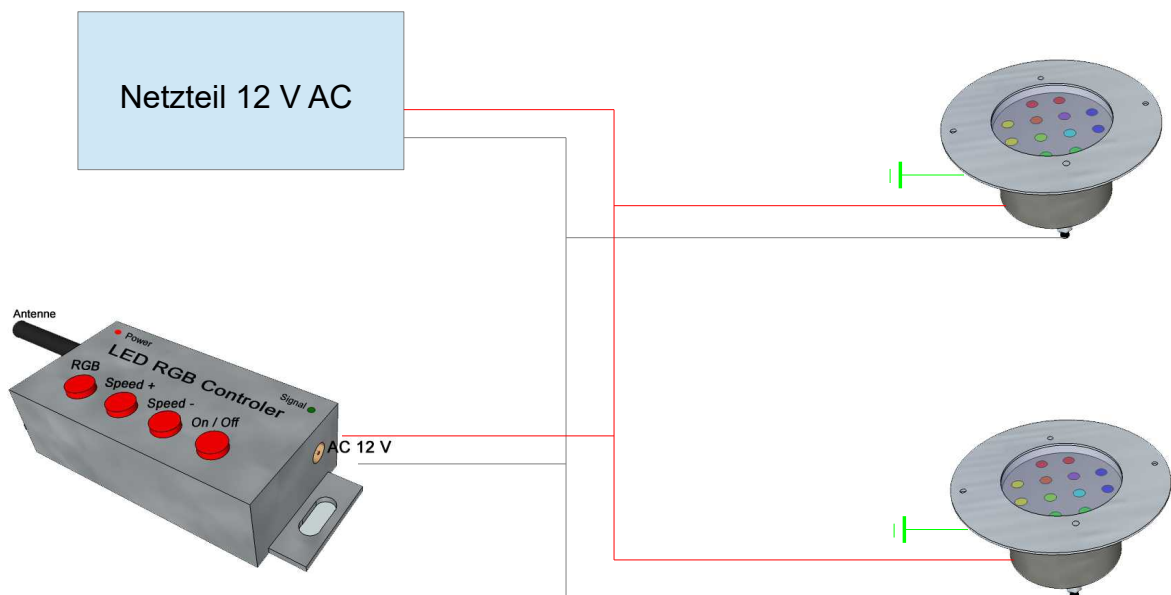

LED RGB Controller mit dem beiliegendem Anschlusskabel anschließen.

Achtung!

Den RGB-LED Controller nicht direkt an das Netzteil, sondern an das Ringkabel (siehe Schaltplan).

Binden

Binden Fernbedienung/Controller

Nach der Installation leuchtet die rote LED am Controller. Den Knopf **On/Off am Controller** und gleichzeitig den Knopf **Off der Fernbedienung** drücken und warten bis der Controller einmal kurz und dann einmal lang piept. Dabei muss die rote LED der Fernbedienung leuchten.

Binden Controller/Leuchtmittel

Nach dem Binden der Fernbedienung auf dem Controller die Tasten On/Off und Speed + drücken und festhalten, bis alle Lampen in den Farbwechsel Rot → Grün → Blau schalten (Synchronisation der Lampen).

Achtung!

Vor Ausschalten des Stromes unbedingt den Controller ausschalten, da es sonst zu einem Verlust von Leuchtmitteln am Controller kommt.

Die Leitungsquerschnitte sind anhand der Leitungslänge und Anzahl der Leuchtmittel durch den Elektriker zu berechnen.

Sicherheitsvorschriften:

- Die mit der Montage beauftragten Personen müssen über die für diese Arbeiten erforderliche Qualifizierung verfügen.
- Der Kontakt mit der elektrischen Spannung muss vermieden werden.
- Vor Arbeiten an der Lampe, Controller oder Netzteil ist der Strom abzuschalten.
- Die LED Lampen sind nur für die Verwendung in Schwimmbecken entworfen. Diese dürfen nur unter Wasser betrieben werden.
- Die LED Lampen dürfen nur mit einem Sicherheitstransformator betrieben werden.
- Der Hersteller übernimmt keinerlei Haftung für die Installation oder Inbetriebnahme.